

ΠΡΟΣ**Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – ‘Ο Άγιος Ανδρέας’**Τσερτίδου 1,
263 32, Πάτρα**Υπόψη :** Γραφείου Προμηθειών**Τηλ. :** 2613-601872**E-mail :** diabouleysi@agandreashosp.gr

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 2295/1110021

ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑ, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 38639/28-9-2021 δημόσιας διαβούλευσης με αντικείμενο την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή των Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων Draeger με ανταλλακτικά»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την παρούσα και αναφορικά με την από 5/10/2021 και με Αρ. Πρωτ.: 28639/28-9-2021, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου σας, πρόσκληση υποβολής σχολίων στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή των Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων Draeger με ανταλλακτικά», η εταιρεία «Draeger Hellas A.E.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, Αρ.150, καταθέτει νομίμως και προσηκόντως τις κάτωθι παρατηρήσεις, **αιτούμενη την τροποποίηση των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών όπως περιγράφονται κατωτέρω:**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
«ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DRAEGER ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	SERIAL
DRAEGER	PRIMUS	ASDJ-0169
DRAEGER	PRIMUS	ASDJ-0165
DRAEGER	PRIMUS	ASDJ-0164
DRAEGER	FABIUS PLUS	ASDJ-0212
DRAEGER	FABIUS GS	ARTM-0097

- Πραγματοποιήθηκαν στον πίνακα του εξοπλισμού μικρές αλλαγές / διορθώσεις στις ονομασίες των μοντέλων

Draeger Hellas A.EΕλευθερίου Βενιζέλου 150,
TK 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com**Draeger Hellas S.A**150, El Venizelou Str.
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

Προδιαγραφή 3:

Όλα τα αναλώσιμα-ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.

Προτεινόμενη Διατύπωση:

Όλα τα αναλώσιμα-ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.

Από τη σύμβαση εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά λειτουργίας καθώς και τα κλιβανιζόμενα υλικά.

Αιτιολόγηση:

Αναλώσιμα θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από τη χρήση τους και δεν δύναται να καλυφθούν από τη σύμβαση συντήρησης.

Προδιαγραφή 4:

Η γενική συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων θα γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι θα είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο ή θα καταθέτουν βεβαιώσεις από άλλα Νοσοκομεία ότι έχουν συντηρήσει καλώς τα ίδια μοντέλα θερμοκοιτίδων και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον δύο ετήσιες συμβάσεις συντήρησης. (Να κατατεθούν και οι συμβάσεις).

Προτεινόμενη Διατύπωση:

Η γενική συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων θα γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι θα είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο. (Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών).

Αιτιολόγηση:

Λόγω του ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν μηχανήματα υποστήριξης ζωής, μόνο εκπαιδευμένοι από εξουσιοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης του κατασκευαστικού οίκου μπορούν να προσφέρουν άρτια τεχνική υποστήριξη στα εν λόγω μηχανήματα.

Προδιαγραφή 6:

Η εταιρεία θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών (εργασία- ανταλλακτικά), που θα παρουσιαστούν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Προτεινόμενη Διατύπωση:

Η εταιρεία θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών (εργασία- ανταλλακτικά), που θα παρουσιαστούν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Η Draeger Hellas δεν φέρει ευθύνη όταν:

1. Όλα τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος δεν αντικαθίστανται σύμφωνα με την συνιστώμενη συχνότητα αλλαγής τους, βάσει των εγχειριδίων χρήσης του μηχανήματος (π.χ. υδατοπαγίδες στα αναισθησιολογικά μηχανήματα).
2. Γίνεται χρήση μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος βασικών αναλωσίμων (π.χ. αισθητήρες ροής, αισθητήρες οξυγόνου).
3. Δεν παρέχεται διαρκώς η κατάλληλη με τις προδιαγραφές των μηχανημάτων τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος και ιατρικών αερίων, και όταν δεν εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες από το κατασκευαστή συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους χώρους του εξοπλισμού.
4. Οι βλάβες προέρχονται από πτώση συσκευής, θραύση και υπαιτιότητα χειριστή ή από προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
5. Δεν τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστικού οίκου.

Αιτιολόγηση:

Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλάβει την επιδιόρθωση βλαβών που οφείλονται σε υπαιτιότητα του χρήστη ή σε εξωγενείς παράγοντες.

Draeger Hellas A.E

Ελευθερίου Βενιζέλου 150,
TK 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

150, El Venizelou Str.
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com



Προδιαγραφή 9:

Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.

Προτεινόμενη Διατύπωση:

Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Σε περίπτωση που από τον Ανάδοχο δοθεί μηχάνημα προς αντικατάσταση, παύει να προσμετράται ο χρόνος εκτός λειτουργίας του μηχανήματος.

Αιτιολόγηση:

Στην περίπτωση που δοθεί μηχάνημα αντικατάστασης συνεχίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. Αναφορικά με το χρόνο εκτός λειτουργίας (Down-Time) οφείλουμε να λάβουμε υπόψη το χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση του τεχνικού, τη διάγνωση της βλάβης, την παραγγελία των υλικών και την παραλαβή τους από τον κατασκευαστικό οίκο, καθώς και τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης.

Τέλος προτείνουμε να προστεθούν στις προδιαγραφές τα ακόλουθα:

Υποχρεώσεις Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της αναδόχου τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κ.λ.π. και απολυμασμένα, ώστε να μην τίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία (των Τεχνικών), και να μην δυσχεραίνεται το έργο τους.

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαφυλάξει τα προσφερόμενα μηχανήματα από τεχνικές παρεμβάσεις οποιονδήποτε ξένων, προς την ανάδοχο τεχνικών.

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους τεχνικούς της αναδόχου ώστε να είναι δυνατή η άνετη, ασφαλής και αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία τους.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως γίνουν αποδεκτά τα σχόλιά μας, προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή μας στην επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.


Με εκτίμηση,

Για την Draeger Hellas A.E.



Γωγώ Δαλέκου
Τμήμα Διαγωνισμών/Προσφορών

DRAEGER HELLAS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ
Α.Φ.Μ.: 997799268 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 009151101000
ΤΗΛ. 210 2821 809 FAX: 210 2821 214

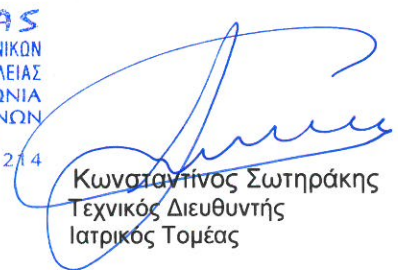

Κωνσταντίνος Σωτηράκης
Τεχνικός Διευθυντής
Ιατρικός Τομέας

Draeger Hellas A.E

Ελευθερίου Βενιζέλου 150,
ΤΚ 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

150, El Venizelou Str.
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

